Guia 2016

implus

SUPERFÍCIE DOS IMPLANTES

ÍNDICE

Pluscut | Maxplus 02

IMPLANTES

IMPLANTES HE*

*Hexágono Externo

Pluscut 04
Pluscut Cortical 05
Maxplus 06
07

IMPLANTES

IMPLANTES HI*

*Hexágono Interno

Pluscut 04
Pluscut Cortical 05
Maxplus 06
07

COMPONENTES PROTÉTICOS

HE Regular 12
HE Estreito 21
HI Regular 30
HI Estreito 39

KITS E INSTRUMENTAIS

Instrumentais 45
Kit Cirúrgico Implus 50

implus

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A LASER

O Tratamento de superfície realizado pela empresa Implus do grupo Baumer, é realizado com a intenção de possibilitar uma excelente e efetiva osseointegração aos implantes instalados.

O acrônimo LASER (Light Amplification Stimulated by Emission of Radiation) significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, o que na prática se traduz em um feixe de luz monocromática, colimada e convergente. São fatores importantes para a indicação do laser: o meio ativo, comprimento de onda, potência e dose aplicada. Os lasers podem ser divididos em de alta ou baixa potência. Os lasers de baixa potência são mais utilizados no tratamento terapêutico, enquanto os de alta potência, para intervenções cirúrgicas, descontaminação bacteriana, alterações na superfície dos implantes, entre outros.

Devido a fatores como biocompatibilidade, o titânio é o principal material comercial para confecção de implantes, o que diferencia a melhor ou a mais rápida resposta do tecido ósseo em torno do implante é a forma de tratamento de superfície aplicada sobre os implantes Implus.

Sendo assim entende-se a texturização a LASER como umas das formas mais puras de se promover a rugosidade sobre o titânio com a finalidade de osseointegração.

As maiores vantagens deste tratamento de superfície e o que a diferencia das demais, é uma possibilidade de homogeneidade e repetição a cada superfície realizada, o que torna um protocolo de instalação de implantes mais seguro em relação aos resultados obtidos.

Outro fator é o fato de ser uma forma limpa de se promover tal rugosidade (somente com a utilização de luz), reduzindo assim a possibilidade de contaminação com outros agentes.

No tratamento da superfície com LASER, não é identificado superaquecimento ou modificações na estrutura do implante, a desestruturação ocorre apenas na superfície do Titânio, aumentando consideravelmente a camada de óxido de titânio, mencionado por inúmeros autores como um dos fatores mais importantes no processo de adesão e diferenciação celular. A literatura apresenta que este aumento da camada de óxido de titânio promove melhor adesão celular e, consquentemente, crescimento de fibroblastos, melhorando a resposta das células ósseas ao processo da osseointegração.

Implantes implus

Família de Implantes Hexágono Externo

PLUSCUT HE



IMPLANTE cilíndrico, disponível na versão Torque Interno
INDEXAÇÃO tipo Hexágono Externo
ROSCA com dupla entrada (exceto plataforma estreita)
SUPERFÍCIE texturizada a laser
TORQUE máximo recomendado: 60 Ncm

DIÂMETRO	3.3	3.5	3.75	4.0	4.3	5.0
ESTREITA	◇					
REGULAR			◇	◇		
LARGA						○

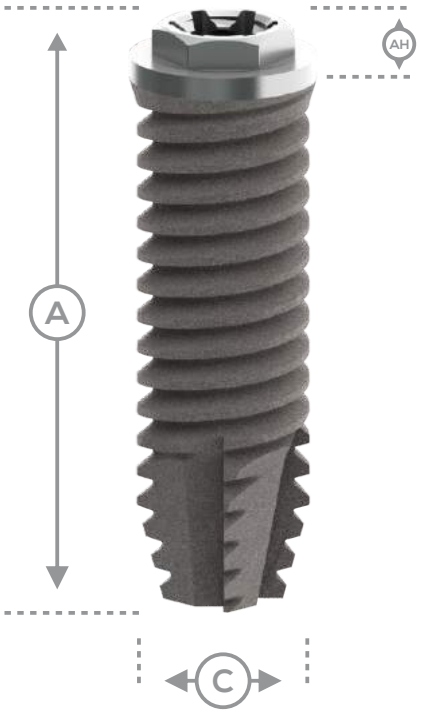

Características Técnicas

	◇ ESTREITA	◇ REGULAR	◇ REGULAR	○ LARGA*
Ø Corpo (C)	3.3	3.75	4.0	5.0
Ø Plataforma	3.5	4.1	4.1	5.0
Rosca Interna	M1.8	M2.0	M2.0	M2.0
Entre Face do Hexágono	2.4	2.7	2.7	2.7
Altura do Hexágono (AH)	1.0	0.7	0.7	0.7
Comprimento do PLUSCUT (A)	10 a 16	7 a 16	7 a 16	7 a 16
Códigos e Comprimentos	INEP.3310-06 10mm INEP.3311-07 11.5mm INEP.3313-08 13mm INEP.3316-10 16mm	IREP.3707-01 7mm IREP.3785-02 8.5mm IREP.3710-03 10mm IREP.3711-04 11.5mm IREP.3713-05 13mm IREP.3716-07 16mm	IREP.4007-08 7mm IREP.4085-09 8.5mm IREP.4010-10 10mm IREP.4011-11 11.5mm IREP.4013-12 13.mm IREP.4016-14 16.mm	IWEP.5007-15 7mm IWEP.5085-16 8.5mm IWEP.5010-17 10mm IWEP.5011-18 11.5mm IWEP.5013-19 13mm IWEP.5016-21 16mm

* plataforma SWITCH

PLUSCUT HE CORTICAL



IMPLANTE cilíndrico, disponível na versão Torque Interno
INDEXAÇÃO tipo Hexágono Externo
ROSCA com dupla entrada (exceto plataforma estreita)
SUPERFÍCIE texturizada a laser
TORQUE máximo recomendado: 60 Ncm

DIÂMETRO	3.3	3.5	3.75	4.0	4.3	5.0
ESTREITA						
REGULAR			◇	◇		
LARGA						○

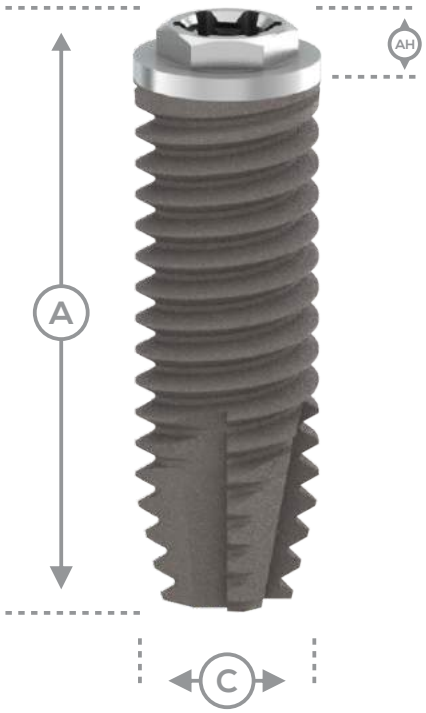

Características Técnicas

	◇ REGULAR	◇ REGULAR	○ LARGA*
Ø Corpo (C)	3.75	4.0	5.0
Ø Plataforma	4.1	4.1	5.0
Rosca Interna	M2.0	M2.0	M2.0
Entre Face do Hexágono	2.7	2.7	2.7
Altura do Hexágono (AH)	0.7	0.7	0.7
Comprimento do PLUSCUT (A)	8.5 a 16	8.5 a 16	8.5 a 16
Códigos e Comprimentos	IREP.3785-22 8.5mm IREP.3710-23 10mm IREP.3711-24 11.5mm IREP.3713-25 13mm IREP.3716-27 16mm	IREP.4085-28 8.5mm IREP.4010-29 10mm IREP.4011-30 11.5mm IREP.4013-31 13mm IREP.4016-33 16mm	IWEP.5085-34 8.5mm IWEP.5010-35 10mm IWEP.5011-36 11.5mm IWEP.5013-37 13mm IWEP.5016-39 16mm

* plataforma SWITCH

MAXPLUS HE



IMPLANTE cônico, disponível na versão Torque Interno
INDEXAÇÃO tipo Hexágono Externo
ROSCA com dupla entrada
SUPERFÍCIE texturizada a laser
TORQUE máximo recomendado: 60 Ncm

DIÂMETRO	3.25	3.5	3.75	4.0	4.3	5.0
ESTREITA			◇			
REGULAR			◇		◇	
LARGA						○

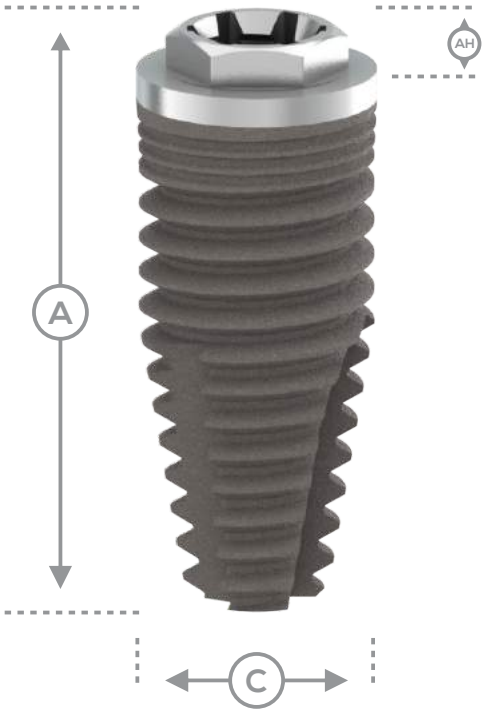

Características Técnicas

	◇ REGULAR	◇ REGULAR	○ LARGA*
Ø Corpo (C)	3.75	4.3	5.0
Ø Plataforma	4.1	4.3	5.0
Rosca Interna	M2.0	M2.0	M2.0
Entre Face do Hexágono	2.7	2.7	2.7
Altura do Hexágono (AH)	0.7	0.7	0.7
Comprimento do PLUSCUT (A)	10 a 16	10 a 16	10 a 16
Códigos e Comprimentos	IREM.3710-21 10mm IREM.3711-22 11.5mm IREM.3713-23 13mm IREM.3716-25 16mm	IWEM.4310-31 10mm IWEM.4311-32 11.5mm IWEM.4313-33 13.mm IWEM.4316-35 16.mm	IWEM.5010-36 10mm IWEM.5011-37 11.5mm IWEM.5013-38 13mm IWEM.5016-40 16mm

* plataforma SWITCH

Implantes implus

Família de Implantes Hexágono Interno

PLUSCUT HI



IMPLANTE cilíndrico, disponível na versão Torque Interno
INDEXAÇÃO tipo Hexágono Interno
ROSCA com dupla entrada (exceto plataforma estreita)
SUPERFÍCIE texturizada a laser
TORQUE máximo recomendado: 60 Ncm

DIÂMETRO	3.25	3.5	3.75	4.0	4.3	5.0
ESTREITA	◇					
REGULAR			◇	◇		
LARGA						○

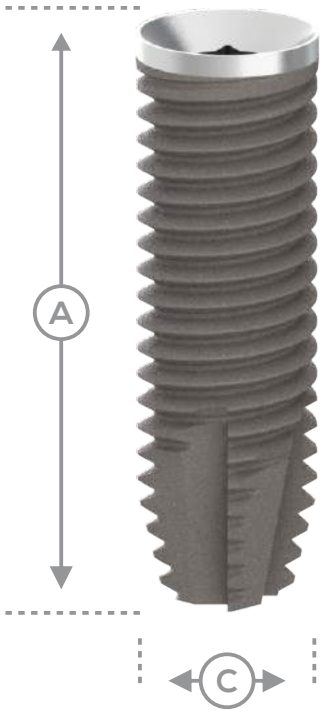

Características Técnicas

	◇ ESTREITA	◇ REGULAR	◇ REGULAR	○ LARGA
Ø Corpo (C)	3.25	3.75	4.0	5.0
Ø Plataforma	3.40	4.1	4.1	5.0
Rosca Interna	M1.6	M1.8	M1.8	M1.8
Entre Face do Hexágono	2.1	2.3	2.3	2.3
Comprimento do PLUSCUT (A)	10 a 16	8.5 a 16	8.5 a 16	8.5 a 16
Códigos e Comprimentos	INIP. 3210-01 10mm INIP. 3211-02 11.5mm INIP. 3213-03 13mm INIP. 3216-05 16mm	IRIP.3785-01 8.5mm IRIP.3710-02 10mm IRIP.3711-03 11.5mm IRIP.3713-04 13mm IRIP.3716-06 16mm	IRIP.4085-07 8.5mm IRIP.4010-08 10mm IRIP.4011-09 11.5mm IRIP.4013-10 13.mm IRIP.4016-12 16.mm	IWIP.5085-13 8.5mm IWIP.5010-14 10mm IWIP.5011-15 11.5mm IWIP.5013-16 13mm IWIP.5016-18 16mm

MAXPLUS HI

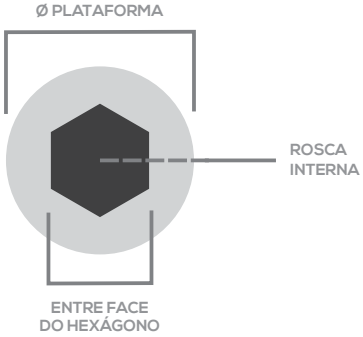

IMPLANTE cônico, disponível na versão Torque Interno
INDEXAÇÃO tipo Hexágono Interno
ROSCA com dupla entrada
SUPERFÍCIE texturizada a laser
TORQUE máximo recomendado: 60 Ncm

DIÂMETRO	3.25	3.5	3.75	4.0	4.3	5.0
ESTREITA						
REGULAR					◇	
LARGA						○

Características Técnicas

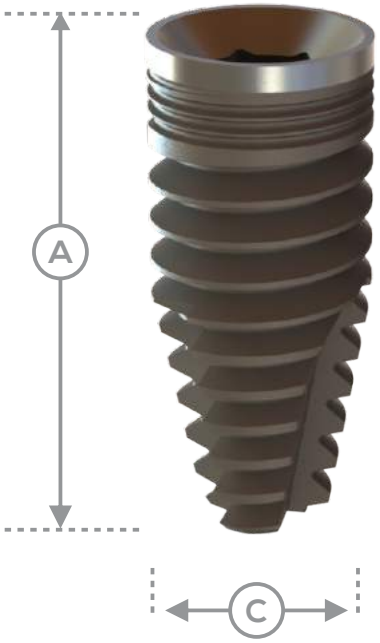

	◇ REGULAR	◇ REGULAR	○ LARGA
Ø Corpo (C)		4.30	5.0
Ø Plataforma		4.30	5.0
Rosca Interna		M1.8	M1.8
Entre Face do Hexágono		2.3	2.3
Comprimento do PLUSCUT (A)		10 a 16	10 a 16
Códigos e Comprimentos		IWIM.4310-21 10mm IWIM.4311-22 11.5mm IWIM.4313-23 13mm IWIM.4316-25 16mm	IWIM.5010-26 10mm IWIM.5011-27 11.5mm IWIM.5013-28 13mm IWIM.5016-30 16mm

PROTOCOLO DE PERFURAÇÃO | IMPLANTES CILÍNDRICOS

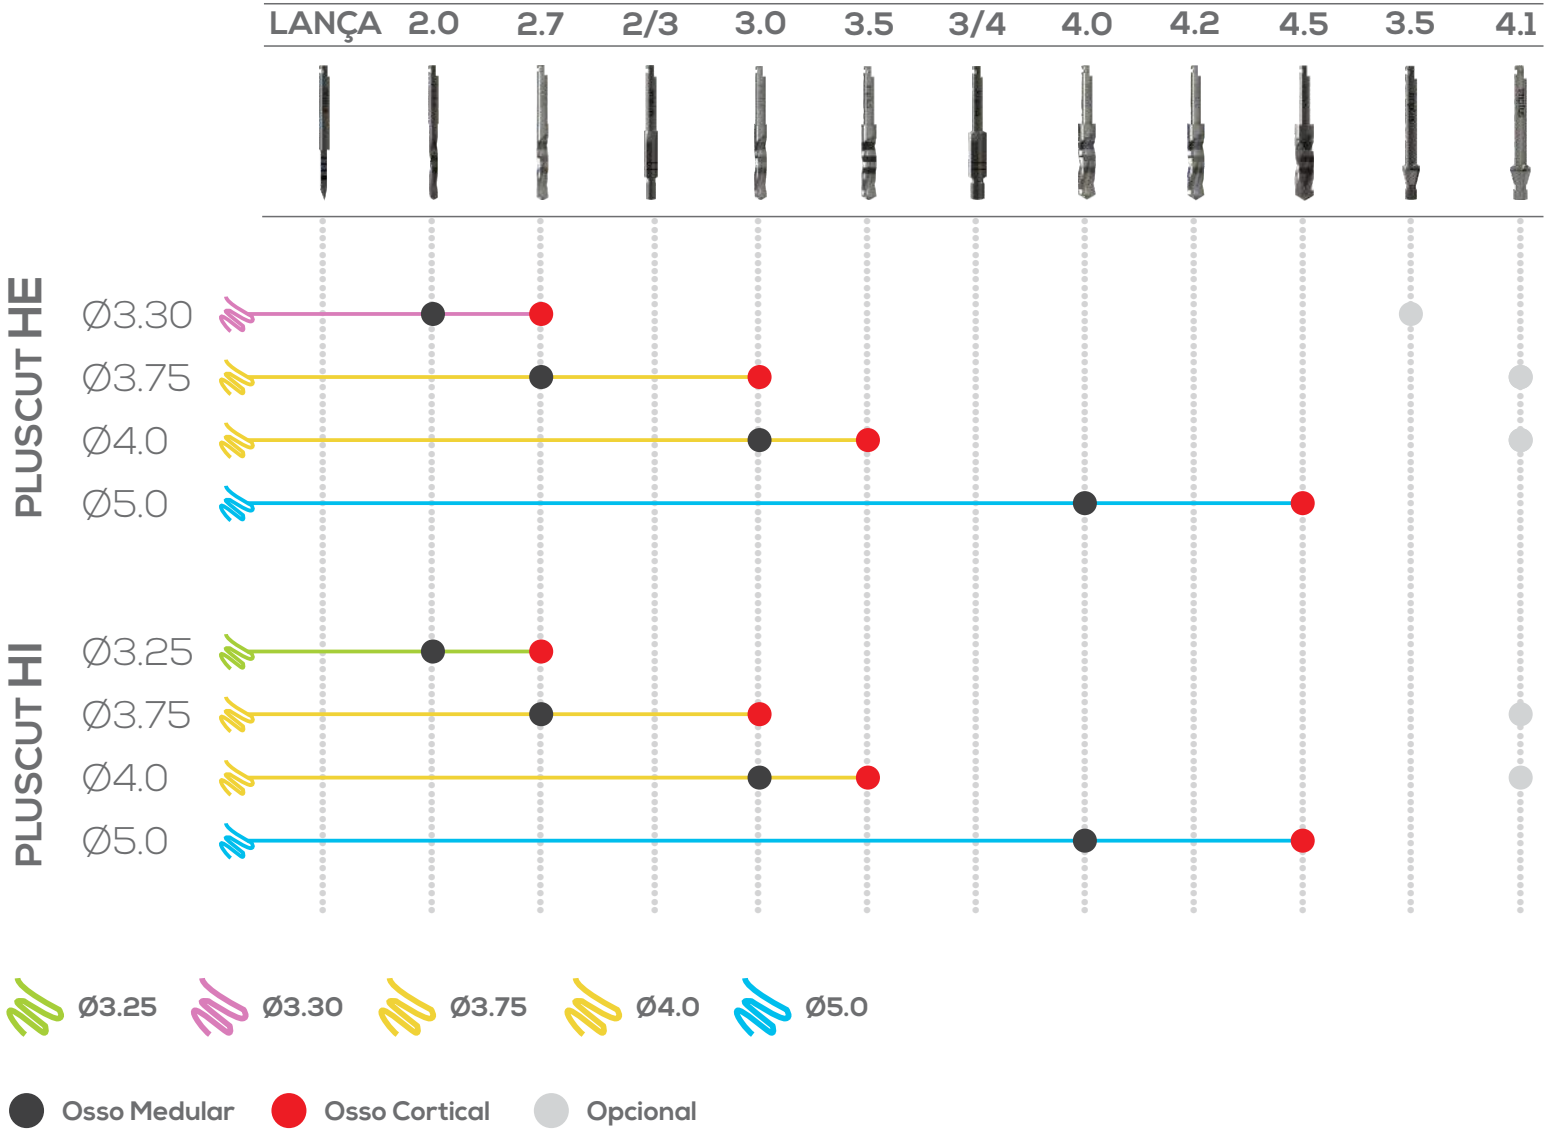

PROTOCOLO DE PERFURAÇÃO | IMPLANTES CÔNICOS

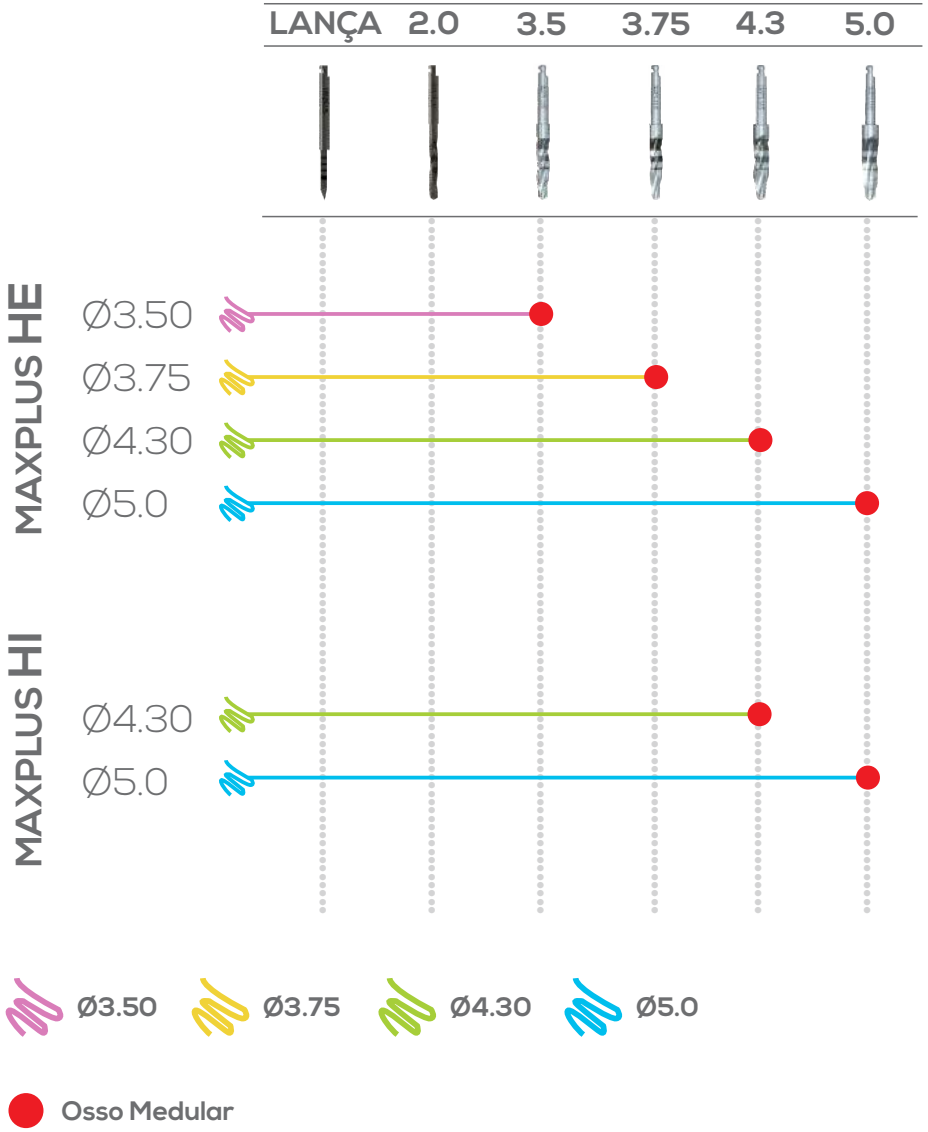

Componentes Protéticos

HE REGULAR

implus

LINHA HE
REGULAR

TAPA IMPLANTE

REF TIRE

CICATRIZADOR DIVERGENTE

REF CDRE.501-05
CDRE.502-06
CDRE.503-07
CDRE.504-08
CDRE.505-09

CDRE.601-10
CDRE.602-11
CDRE.603-12
CDRE.604-13
CDRE.605-14

CICATRIZADOR C/ EMERGÊNCIA

REF CERE.453-05
CERE.454-06
CERE.455-07
CERE.456-08

CICATRIZADOR PARALELO

REF CPRE.413-04
CPRE.414-05
CPRE.415-06

UCLA TITÂNIO

REF PURE.M.4515-02
PURE.U.4515-04

UCLA CR-CO

REF PURE.U.4511-05
PURE.M.4511-06

UCLA PLÁSTICA

REF PURE.U.4515-07
PURE.M.4515-08

PILAR DIVERGENTE

REF PDRE.501-05
PDRE.502-06
PDRE.503-07
PDRE.504-08
PDRE.505-09

PDRE.601-10
PDRE.602-11
PDRE.603-12
PDRE.604-13
PDRE.605-14

PILAR PARALELO

REF PLRE.4110-02

PILAR ANGULADO 15°

REF PARE.501-01
PARE.502-02
PARE.601-05
PARE.602-06

PILAR ANGULADO 30°

REF PARE.501-13
PARE.502-14
PARE.601-15
PARE.602-16

PILAR BOLA

REF PBRE.412-05
PBRE.413-06
PBRE.414-07
PBRE.415-08
PBRE.416-09

FÊMEA DO PILAR BOLA

REF PBRE-F

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPPB

ANEL ESPAÇADOR

REF AEPB

TRANSFERÊNCIA MOLDEIRA ABERTA

REF TRIRMAE

TRANSFERÊNCIA MOLDEIRA FECHADA

REF TRIRMFE

ANÁLOGO DO IMPLANTE

REF AIRE

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPRE-02

PILAR MICROUNIT

REF PMRE.481-06
PMRE.482-07
PMRE.483-08
PMRE.484-09
PMRE.485-10

PILAR MICROUNIT ANGULADO 17°

REF PMARE.482-05
PMARE.483-06

PILAR MICROUNIT ANGULADO 30°

REF PMARE.483-07
PMARE.484-08

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

REF TRMRMA

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

REF TRMRMF

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPMI.484-01

COPING TITÂNIO

REF COMIM.5312-01

COPING CR-CO

REF COMIM.5313-03

COPING PLÁSTICO

REF COMIM.5312-05

ANÁLOGO DO PILAR MICROUNIT

REF APMR

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPCMI

PILAR ESTETICONE

REF PERE.481-04
PERE.482-05
PERE.483-06

PILAR ESTETICONE ANGULADO 17°

REF PEARE.482-05
PEARE.483-06

PILAR ESTETICONE ANGULADO 30°

REF PEARE.483-07
PEARE.484-08

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

REF TRERMA-01
TRERMA-02

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

REF TRERMF

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPESR.486-02

COPING TITÂNIO

REF COESRU.5212-03
COESRM.5212-04

COPING CR-CO

REF COESRM.5313-07
COESRU.5313-08

COPING PLÁSTICO

REF COESRM.5212-09
COESRU.5212-10

ANÁLOGO DO PILAR ESTÉTICONE COM HEXÁGONO

REF AERCH

ANÁLOGO DO PILAR ESTÉTICONE SEM HEXÁGONO

REF AERSH

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPCMI

COMPONENTES PROTÉTICOS

TAPA IMPLANTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.4
Altura Total	1.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M2
Código	TIRE
Indexação	-

CICATRIZADOR C/ EMERGÊNCIA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CERE.Ref (CERE.453-05)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.5	4.5	4.5	4.5
Altura Total	3.0	4.0	5.0	6.0
Cinta (mm)	1	1	1	1
Rosca	M2	M2	M2	M2
Código	453-05	454-06	455-07	456-08
Indexação	-	-	-	-

UCLA DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.5	4.5
Altura Total	15.0	15.0
Cinta (mm)	1.0	1.0
Rosca	-	-
Código	PURE.M.4515-02	PURE.U.4515-04
Indexação	S/HEX	C/HEX

CICATRIZADOR DIVERGENTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CDRE.Ref (CDRE.501-05)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Altura Total	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
Cinta (mm)	1	2	3	4	5
Rosca	M2	M2	M2	M2	M2
Código	501-05	502-06	503-07	504-08	505-09
Indexação	-	-	-	-	-

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Altura Total	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
Cinta (mm)	1	2	3	4	5
Rosca	M2	M2	M2	M2	M2
Código	.601-10	602-11	603-12	604-13	605-14
Indexação	-	-	-	-	-

CICATRIZADOR PARALELO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CPRE.Ref (CPRE.413-04)

Plataforma	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.1	4.1	4.1
Altura Total	3.0	4.0	5.0
Cinta (mm)	-	-	-
Rosca	M2	M2	M2
Código	413-04	414-05	415-06
Indexação	-	-	-

UCLA PLÁSTICA

MATERIAL: Plástico
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.5	4.5
Altura Total	15.0	15.0
Cinta (mm)	1.0	1.0
Rosca	-	-
Código	PURE.U.4511-05	PURE.M.4511-06
Indexação	C/HEX	S/HEX

COMPONENTES PROTÉTICOS

UCLA Cr-Co

MATERIAL: Cinta Metálica Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.5	4.5
Altura Total	11.0	11.0
Cinta (mm)	1.0	1.0
Rosca	-	-
Código	PURE.U.4515-07	PURE.M.4515-08
Indexação	C/HEX	S/HEX

PILAR PARALELO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	10.5
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	PLRE.4110-02
Indexação	-

PILAR ANGULADO 15°

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PARE.Ref (PARE.501-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	5.0	5.0	6.0	6.0
Altura Total	10.6	11.6	10.6	11.6
Cinta (mm)	1.0	2.0	1.0	2.0
Rosca	-	-	-	-
Código	501-01	502-02	601-05	602-06
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

PILAR DIVERGENTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PDRE.Ref (PDRE.501-05)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Altura Total	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
Cinta (mm)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Rosca	-	-	-	-	-
Código	501-05	502-06	503-07	504-08	505-09
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Altura Total	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
Cinta (mm)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Rosca	-	-	-	-	-
Código	501-10	502-11	503-12	504-13	505-14
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

PILAR ANGULADO 30°

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PARE.Ref (PARE.501-13)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	5.0	5.0	6.0	6.0
Altura Total	10.5	11.5	12.5	13.5
Cinta (mm)	1.0	2.0	1.0	2.0
Rosca	-	-	-	-
Código	501-13	502-14	601-15	602-16
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

PILAR BOLA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PBRE.Ref (PBRE.412-05)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
Altura Total	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
Cinta (mm)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Rosca	M2	M2	M2	M2	M2
Código	412-05	413-06	414-07	415-08	416-09
Indexação	-	-	-	-	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.0
Altura Total	22.9
Cinta (mm)	-
Rosca	M2
Código	TRIRMAE
Indexação	C/HEX

ANÁLOGO DO IMPLANTE

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	10.7
Cinta (mm)	-
Rosca	M2
Código	AIRE
Indexação	-

FÊMEA DO PILAR BOLA

MATERIAL: Titânio e Borracha
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	3.9
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	PBRE-F
Indexação	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	13.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M2
Código	TRIRMFE
Indexação	C/HEX

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.5
Altura Total	7.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M2
Código	PPRE-02
Indexação	-

PILAR MICROUNIT

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PMRE.Ref (PMRE.481-06)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Altura Total	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2
Cinta (mm)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Rosca	M2	M2	M2	M2	M2
Código	481-06	482-07	483-08	484-09	485-10
Indexação	S/HEX	S/HEX	S/HEX	S/HEX	S/HEX

PILAR MICROUNIT ANGULADO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PMARE.Ref (PMARE.482-05)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8	4.8
Altura Total	4.2	5.2	4.2	5.2
Cinta (mm)	2.5	3.5	3.0	4.0
Rosca	M2	M2	M2	M2
Código	482-05	483-06	483-07	484-08
Indexação	17°	17°	30°	30°

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRMRMA
Indexação	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	8.2
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRMRMF
Indexação	-

TAMPA DE PROTEÇÃO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	4.7
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TPMI.484-01
Indexação	-

COPING DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	12.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5312-01
Indexação	S/HEX

COPING DE Cr-Co

MATERIAL: Cinta metálica Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	13.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5313-03
Indexação	S/HEX

ANÁLOGO DO PILAR MICROUNIT

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	14.2
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	APMR
Indexação	-

COPING DE PLÁSTICO

MATERIAL: Plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	12.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5312-05
Indexação	S/HEX

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.3
Altura Total	4.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	PPCMI
Indexação	-

LINHA ESTETICONE REGULAR

PILAR ESTETICONE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32 Ncm
REF: PERE.Ref (PERE.481-04)

Plataforma	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8
Altura Total	4.8	5.8	6.8
Cinta (mm)	1.0	2.0	3.0
Rosca	M2	M2	M2
Código	481-04	482-05	483-06
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX

PILAR ESTETICONE ANGULADO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32 Ncm
REF: PEARE.Ref (PEARE.482-05)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8	4.8
Altura Total	5.2	6.2	5.5	6.5
Cinta (mm)	2.0	3.0	3.0	4.0
Rosca	M2	M2	M2	M2
Código	482-05	483-06	483-07	484-08
Angulação	17°	17°	30°	30°
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	5.3	5.3
Altura Total	13.5	13.5
Cinta (mm)	-	-
Rosca	M1.4	M1.4
Código	TRERMA-01	TRERMA-02
Indexação	C/HEX	S/HEX

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	8.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRERMF
Indexação	S/HEX

TAMPA DE PROTEÇÃO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	6.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TPESR.486-02
Indexação	-

COPING DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	5.2	5.2
Altura Total	12.0	12.0
Cinta (mm)	-	-
Rosca	-	-
Código	COESR.M.5212-04	COESR.U.5212-03
Indexação	S/HEX	C/HEX

LINHA ESTETICONE REGULAR

COPING DE Cr-Co

MATERIAL: Cinta metálica de Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	5.2	5.2
Altura Total	13.9	13.9
Cinta (mm)	-	-
Rosca	-	-
Código	COESR.M.5313-07	COESR.U.5313-08
Indexação	S/HEX	C/HEX

COPING DE PLÁSTICO

MATERIAL: Plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	5.2	5.2
Altura Total	12.0	12.0
Cinta (mm)	-	-
Rosca	-	-
Código	COESR.M.5212-09	COESR.U.5212-10
Indexação	S/HEX	C/HEX

ANÁLOGO DO PILAR ESTETICONE C/ HEXÁGONO

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	AERCH
Indexação	C/HEX

ANÁLOGO DO PILAR ESTETICONE S/ HEXÁGONO

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	AERSH
Indexação	S/HEX

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.3
Altura Total	4.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	PPCMI
Indexação	-

Componentes Protéticos

HE ESTREITO

implus

LINHA HE
ESTREITO

TAPA IMPLANTE

REF TINE

CICATRIZADOR DIVERGENTE

REF CDNE.401-01
CDNE.402-02
CDNE.403-03
CDNE.404-04

CICATRIZADOR C/ EMERGÊNCIA

REF CENE.403-01
CENE.404-02
CENE.405-03
CENE.406-04

CICATRIZADOR PARALELO

REF CPNE.353-01
CPNE.354-02
CPNE.355-03

UCLA TITÂNIO

REF PUNE.M.3915-01
PUNE.U.3915-03

UCLA CR-CO

REF PUNE.U.3811-04
PUNE.M.3811-05

UCLA PLÁSTICA

REF PUNE.U.3915-06
PUNE.M.3915-07

PILAR DIVERGENTE

REF PDNE.401-01
PDNE.402-02
PDNE.403-03
PDNE.404-04

PILAR PARALELO

REF PLNE.3510-01

PILAR ANGULADO 15°

REF PANE.411-01
PANE.412-02

PILAR ANGULADO 30°

REF PANE.411-03
PANE.412-04

PILAR BOLA

REF PBNE.352-01
PBNE.353-02
PBNE.354-03
PBNE.355-04

FÊMEA DO PILAR BOLA

REF PBRE-F

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPPB

ANEL ESPAÇADOR

REF AEPB

TRANSFERÊNCIA MOLDEIRA ABERTA

REF TRINMAE

TRANFERÊNCIA MOLDEIRA FECHADA

REF TRINMFE

ANÁLOGO DO IMPLANTE

REF AINE

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPNE-01

PILAR MICROUNIT

REF PMNE.481-01
PMNE.482-02
PMNE.483-03
PMNE.484-04

PILAR MICROUNIT ANGULADO 17 °

REF PMANE.483-01
PMANE.484-02

PILAR MICROUNIT ANGULADO 30°

REF PMANE.483-03
PMANE.484-04

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

REF TRMRMA

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

REF TRMRMF

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPMI.484-01

COPING TITÂNIO

REF COMIM.5312-01

COPING CR-CO

REF COMIM.5313-03

COPING PLÁSTICO

REF COMIM.5312-05

ANÁLOGO DO PILAR MICROUNIT

REF APMR

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPCMI

PILAR ESTETICONE

REF PENE.401-01
PENE.402-02
PENE.403-03

PILAR ESTETICONE ANGULADO 17°

REF PEANE.402-01
PEANE.403-02

PILAR ESTETICONE ANGULADO 30°

REF PEANE.402-03

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

REF TRENMA-01
TRENMA-02

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

REF TRENMF

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPESN.405-01

COPING TITÂNIO

REF COESN.U.4412-01
COESN.M.4412-02

COPING CR-CO

REF COESN.M.4412-05
COESN.U.4412-06

COPING PLÁSTICO

REF COESN.M.4412-11
COESN.U.4412-12

ANÁLOGO DO PILAR ESTÉTICONE COM HEXÁGONO

REF AENCH

ANÁLOGO DO PILAR ESTÉTICONE SEM HEXÁGONO

REF AENSH

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPCMI

COMPONENTES PROTÉTICOS ESTREITO

TAPA IMPLANTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	3.8
Altura Total	1.85
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.8
Código	TINE
Indexação	-

CICATRIZADOR C/ EMERGÊNCIA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CENE.Ref (CENE.403-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.0	4.0	4.0	4.0
Altura Total	3.0	4.0	5.0	6.0
Cinta (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	403-01	404-02	405-03	406-04
Indexação	-	-	-	-

UCLA DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PUNE.Ref (PUNE.M.3915-01)

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	3.9	3.9
Altura Total	15	15
Cinta (mm)	1.5	1.5
Rosca	-	-
Código	M.3915-01	U.3915-03
Indexação	S/HEX	C/HEX

CICATRIZADOR DIVERGENTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CDNE.Ref (CDNE.401-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.0	4.0	4.0	4.0
Altura Total	3.8	4.8	5.8	6.8
Cinta (mm)	1.0	2.0	3.0	4.0
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	401-01	402-02	403-03	404-04
Indexação	-	-	-	-

CICATRIZADOR PARALELO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CPNE.Ref (CPNE.353-01)

Plataforma	◇	◇	◇
Ø (mm)	3.50	3.50	3.50
Altura Total	3.0	4.0	5.0
Cinta (mm)	-	-	-
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8
Código	353-01	354-02	355-03
Indexação	-	-	-

UCLA PLÁSTICA

MATERIAL: Plástico
TORQUE: 32Ncm
REF: PUNE.Ref (PUNE.U.3915-06)

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	3.9	3.9
Altura Total	15	15
Cinta (mm)	1.5	1.5
Rosca	-	-
Código	U.3915-06	3915-07
Indexação	C/HEX	S/HEX

COMPONENTES PROTÉTICOS ESTREITO

UCLA CR-CO

MATERIAL: Cinta metálica de Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 32Ncm
REF: PUNE.Ref (PUNE.U.3811-04)

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	3.8	3.8
Altura Total	11.0	11.0
Cinta (mm)	1.5	1.5
Rosca	-	-
Código	U.3811-04	M.3811-05
Indexação	C/HEX	S/HEX

PILAR PARALELO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PLNE.Ref (PLNE.3510-01)

Plataforma	◇
Ø (mm)	3.5
Altura Total	10.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	3510-01
Indexação	C/HEX

PILAR ANGULADO 15°

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PANE.Ref (PANE.411-01)

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.1	4.1
Altura Total	10.4	11.4
Cinta (mm)	1.0	2.0
Rosca	-	-
Código	411-01	412-02
Angulação	15°	15°

PILAR DIVERGENTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PDNE.Ref (PDNE.401-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.0	4.0	4.0	4.0
Altura Total	10.0	11.0	12.0	13.0
Cinta (mm)	1.0	2.0	3.0	4.0
Rosca	-	-	-	-
Código	401-01	402-02	403-03	404-04
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

PILAR ANGULADO 30°

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PANE.Ref (PANE.411-05)

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.1	4.1
Altura Total	10.1	11.1
Cinta (mm)	1.0	2.0
Rosca	-	-
Código	411-03	412-04
Angulação	30°	30°

COMPONENTES PROTÉTICOS ESTREITO

PILAR BOLA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PBNE.Ref (PBNE.352-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	3.5	3.5	3.5	3.5
Altura Total	5.0	6.0	7.0	8.0
Cinta (mm)	2.0	3.0	4.0	5.0
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	352-01	353-02	354-03	355-04
Indexação	-	-	-	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.80
Altura Total	19
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.8
Código	TRINMAE
Indexação	C/HEX

ANÁLOGO DO IMPLANTE

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	3.50
Altura Total	10.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	AINE
Indexação	-

FÊMEA DO PILAR BOLA

MATERIAL: Titânio e Borracha
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	3.90
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	PBRE.F
Indexação	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	3.50
Altura Total	15.70
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.8
Código	TRINMFE
Indexação	C/HEX

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.2
Altura Total	7.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.8
Código	PPNE-01
Indexação	-

LINHA MICROUNIT ESTREITO

PILAR MICROUNIT ESTREITO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PMNE.Ref (PMNE.481-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8	4.8
Altura Total	2.4	3.4	4.4	5.4
Cinta (mm)	1.0	2.0	3.0	4.0
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	481-01	482-02	483-03	484-04
Indexação	S/HEX	S/HEX	S/HEX	S/HEX

PILAR MICROUNIT ANGULADO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PMANE.Ref (PMANE.483-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8	4.8
Altura Total	4.7	5.7	4.2	5.2
Cinta (mm)	3.0	4.0	3.0	4.0
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	483-01	484-02	483-03	484-04
Angulação	17°	17°	30°	30°
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRMRMA
Indexação	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	8.2
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRMRMF
Indexação	-

TAMPA DE PROTEÇÃO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	4.7
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TPMI.484-01
Indexação	-

COPING DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	12.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5312-01
Indexação	S/HEX

COPING DE Cr-Co

MATERIAL: Cinta metálica Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	13.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5313-03
Indexação	S/HEX

ANÁLOGO DO PILAR MICROUNIT

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	14.2
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	APMR
Indexação	-

COPING DE PLÁSTICO

MATERIAL: Plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	12.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5312-05
Indexação	S/HEX

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.3
Altura Total	4.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	PPCMI
Indexação	-

LINHA ESTETICONE ESTREITO

PILAR ESTETICONE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.0	4.0	4.0
Altura Total	4.1	5.1	6.1
Cinta (mm)	1.0	2.0	3.0
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8
Código	PENE.401-01	PENE.402-02	PENE.403-03
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX

PILAR ESTETICONE ANGULADO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PEANE.Ref (PEANE.402-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.0	4.0	4.0	4.0
Altura Total	5.1	6.1	4.6	5.6
Cinta (mm)	2.5	3.5	2.5	3.5
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	402-01	403-02	402-03	403-04
Angulação	17°	17°	30°	30°
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	5.3	5.3
Altura Total	13.0	13.0
Cinta (mm)	-	-
Rosca	M1.4	M1.4
Código	TRENMA-01	TRENMA-02
Indexação	C/HEX	S/HEX

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.0
Altura Total	8.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRENMF
Indexação	S/HEX

TAMPA DE PROTEÇÃO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.0
Altura Total	5.3
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TPESN.405-01
Indexação	-

COPING DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.4	4.4
Altura Total	12.0	12.0
Cinta (mm)	-	-
Rosca	-	-
Código	COESN.U.4412-01	COESN.M.4412-02
Indexação	C/HEX	S/HEX

LINHA ESTETICONE ESTREITO

COPING DE Cr-Co

MATERIAL: Cinta metálica de Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.4	4.4
Altura Total	12.45	12.45
Cinta (mm)	-	-
Rosca	-	-
Código	COESN.M.4412-05	COESN.U.4412-06
Indexação	S/HEX	C/HEX

COPING DE PLÁSTICO

MATERIAL: Plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.4	4.4
Altura Total	12.0	12.0
Cinta (mm)	-	-
Rosca	-	-
Código	COESN.M.4412-11	COESN.U.4412-12
Indexação	S/HEX	C/HEX

ANÁLOGO DO PILAR ESTETICONE C/ HEXÁGONO

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.0
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	AENCH
Indexação	C/HEX

ANÁLOGO DO PILAR ESTETICONE S/ HEXÁGONO

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.0
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	AENSH
Indexação	S/HEX

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.3
Altura Total	4.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	PPCMI
Indexação	-

Componentes Protéticos

HI REGULAR

implus

LINHA HI
REGULAR

TAPA IMPLANTE

REF TIRI

CICATRIZADOR DIVERGENTE

REF CDRI.501-01
CDRI.502-02
CDRI.503-03
CDRI.504-04
CDRI.505-05
CDRI.601-06
CDRI.602-07
CDRI.603-08
CDRI.604-09
CDRI.605-10

CICATRIZADOR C/ EMERGÊNCIA

REF CERI.453-01
CERI.454-02
CERI.455-03
CERI.456-04
CERI.457-05
CERI.603-06
CERI.604-07
CERI.605-08
CERI.606-09
CERI.607-10

UCLA TITÂNIO

REF PURIM.4516-01
PURIU.4516-02

UCLA CR-CO

REF PURIU.4513-03
PURIM.4513-04

PILAR DIVERGENTE

REF PDRI.501-01
PDRI.502-02
PDRI.503-03
PDRI.504-04
PDRI.505-05
PDRI.601-06
PDRI.602-07
PDRI.603-08
PDRI.604-09
PDRI.605-10

PILAR PARALELO

REF PLRI.4112-01

PILAR ANGULADO 15°

REF PARI.501-05
PARI.502-06
PARI.601-07
PARI.602-08

PILAR ANGULADO 30°

REF PARI.501-01
PARI.502-02
PARI.601-03
PARI.602-04

PILAR BOLA

REF PBRI.412-01
PBRI.413-02
PBRI.414-03
PBRI.415-04
PBRI.416-05

FÊMEA DO PILAR BOLA

REF PBRE-F

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPPB

ANEL ESPAÇADOR

REF AEPB

TRANSFERÊNCIA MOLDEIRA ABERTA

REF TRIRMAI

TRANFERÊNCIA MOLDEIRA FECHADA

REF TRIRMFI

ANÁLOGO DO IMPLANTE

REF AIRI

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPRI-04

PILAR MICROUNIT

REF PMRI.M.481-01
PMRI.M.482-02
PMRI.M.483-03
PMRI.M.484-04

PILAR MICROUNIT ANGULADO

REF PMARI.U.482-01
PMARI.U.483-02
PMARI.U.483-03
PMARI.U.484-04

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

REF TRMRMA

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

REF TRMRMF

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPMI.484-01

COPING TITÂNIO

REF COMIM.5312-01

COPING CR-CO

REF COMIM.5313-03

COPING PLÁSTICO

REF COMIM.5312-05

ANÁLOGO DO PILAR MICROUNIT

REF APMR

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPCMI

PILAR ESTETICONE

REF PERI.481-01
PERI.482-02
PERI.483-03
PERI.484-04

PILAR ESTETICONE ANGULADO

REF PEARI.482-01
PEARI.483-02
PEARI.483-03
PEARI.484-04

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

REF TRERMA-01
TRERMA-02

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

REF TRERMF

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPESR.486-01

COPING TITÂNIO

REF COESRU.5212-03
COESRM.5212-04

COPING CR-CO

REF COESRM.5313-07
COESRU.5313-08

COPING PLÁSTICO

REF COESRM.5212-09
COESRU.5212-10

ANÁLOGO DO PILAR ESTÉTICONE COM HEXÁGONO

REF AECH

ANÁLOGO DO PILAR ESTÉTICONE SEM HEXÁGONO

REF AESH

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPCMI

COMPONENTES PROTÉTICOS

TAPA IMPLANTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.4
Altura Total	1.6
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.8
Código	TIRI
Indexação	-

CICATRIZADOR DIVERGENTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CDRI.Ref (CDRI.501-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Altura Total	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
Cinta (mm)	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	501-01	502-02	503-03	504-04	505-05
Indexação	-	-	-	-	-

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Altura Total	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
Cinta (mm)	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	601-06	602-07	603-08	604-09	605-10
Indexação	-	-	-	-	-

CICATRIZADOR C/ EMERGÊNCIA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CERI.Ref (CERI.453-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Altura Total	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
Cinta (mm)	-	-	-	-	-
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	453-01	454-02	455-03	456-04	457-05
Indexação	-	-	-	-	-

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Altura Total	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
Cinta (mm)	-	-	-	-	-
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	603-06	604-07	605-08	606-09	607-10
Indexação	-	-	-	-	-

UCLA DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.5	4.5
Altura Total	14.0	14.0
Cinta (mm)	1.1	1.1
Rosca	-	-
Código	PURI.M.4516-01	PURI.U.4516-02
Indexação	S/HEX	C/HEX

UCLA CR-CO

MATERIAL: Cinta metálico de Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.5	4.5
Altura Total	14.0	14.0
Cinta (mm)	1.1	1.1
Rosca	-	-
Código	PURI.U.4513-03	PURI.M.4513-04
Indexação	C/HEX	S/HEX

COMPONENTES PROTÉTICOS

PILAR DIVERGENTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PDRI.Ref (PDRI.501-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Altura Total	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1
Cinta (mm)	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1
Rosca	-	-	-	-	-
Código	501-01	502-02	503-03	504-04	505-05
Indexação	-	-	-	-	-

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Altura Total	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1
Cinta (mm)	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1
Rosca	-	-	-	-	-
Código	601-06	602-07	603-08	604-09	605-10
Indexação	-	-	-	-	-

PILAR PARALELO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	10.5
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	PLRI.4112-01
Indexação	-

PILAR ANGULADO 15°

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PARI.Ref (PARI.501-05)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	5.0	5.0	6.0	6.0
Altura Total	10.7	11.7	10.9	11.9
Cinta (mm)	1.0	2.0	1.0	2.0
Rosca	-	-	-	-
Código	501-05	502-06	601-07	602-08
Indexação	15	15	15	15

PILAR ANGULADO 30°

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PARI.Ref (PARI.501-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	5.0	5.0	6.0	6.0
Altura Total	10.6	11.7	10.9	11.9
Cinta (mm)	1.0	2.0	1.0	2.0
Rosca	-	-	-	-
Código	501-01	502-02	601-03	602-04
Indexação	30	30	30	30

PILAR BOLA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PBRI.Ref (PBRI.412-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
Altura Total	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2
Cinta (mm)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	412-01	413-02	414-03	415-04	416-05
Indexação	-	-	-	-	-

FÊMEA DO PILAR BOLA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Não aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	3.9
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	PBRE-F
Indexação	-

COMPONENTES PROTÉTICOS

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	18.9
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.8
Código	TRIRMAI
Indexação	-

ANÁLOGO DO IMPLANTE

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	10.7
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.8
Código	AIRI
Indexação	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	13.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.8
Código	TRIRMFI
Indexação	-

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.3
Altura Total	4.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	PPCMI
Indexação	-

PILAR MICROUNIT

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PMRI.M.Ref (PMRI.M.481-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8	4.8
Altura Total	3.3	4.3	5.3	6.3
Cinta (mm)	1.1	2.1	3.1	4.1
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	481-01	482-02	483-03	484-04
Indexação	S/HEX	S/HEX	S/HEX	S/HEX

PILAR MICROUNIT ANGULADO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PMARI.U.Ref (PMARI.U.482-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8	4.8
Altura Total	4.3	5.3	4.3	5.3
Cinta (mm)	2.5	3.5	3.0	4.0
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	482-01	483-02	483-03	484-04
Angulação	17°	17°	30°	30°
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRMRMA
Indexação	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	8.2
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRMRMF
Indexação	-

TAMPA DE PROTEÇÃO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	4.7
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TPMI.484-01
Indexação	-

COPING DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	12.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5312-01
Indexação	S/HEX

COPING DE Cr-Co

MATERIAL: Cinta metálica Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	13.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5313-03
Indexação	S/HEX

ANÁLOGO DO PILAR MICROUNIT

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	14.2
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	APMR
Indexação	-

COPING DE PLÁSTICO

MATERIAL: Plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	12.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5312-05
Indexação	S/HEX

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.3
Altura Total	4.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	PPCMI
Indexação	-

LINHA ESTETICONE REGULAR

PILAR ESTETICONE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PERI.Ref (PERI.481-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8	4.8
Altura Total	4.9	5.9	6.9	7.9
Cinta (mm)	1.1	2.1	3.1	4.1
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	481-01	482-02	483-03	484-04
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

PILAR ESTETICONE ANGULADO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PEARI.Ref (PEARI.482-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8	4.8
Altura Total	5.3	6.3	5.6	6.6
Cinta (mm)	2.1	3.1	3.1	4.1
Rosca	M1.8	M1.8	M1.8	M1.8
Código	482-01	483-02	483-03	484-04
Angulação	17°	17°	30°	30°
Indexação	C/HEX	C/HEX	C/HEX	C/HEX

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	5.0	5.0
Altura Total	18.9	13.0
Cinta (mm)	-	-
Rosca	M1.4	M1.4
Código	TRIRMAI	TRENMA-02
Indexação	C/HEX	

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.1
Altura Total	18.75
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	TRIRMFI
Indexação	S/HEX

TAMPA DE PROTEÇÃO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	6.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	TPESN.486-02
Indexação	-

COPING DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.4	4.4
Altura Total	12.0	12.0
Cinta (mm)	-	-
Rosca	-	-
Código	COESR.U.5212-03	COESR.M.5212-04
Indexação	C/HEX	S/HEX

LINHA ESTETICONE REGULAR

COPING DE Cr-Co

MATERIAL: Cinta metálica de Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.4	4.4
Altura Total	12.0	12.0
Cinta (mm)	-	-
Rosca	-	-
Código	COESR.M.5313-07	COESR.U.5313-08
Indexação	S/HEX	C/HEX

ANÁLOGO DO PILAR ESTETICONE C/ HEXÁGONO

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.0
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	AECHN
Indexação	C/HEX

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.3
Altura Total	4.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	PPCMI
Indexação	-

COPING DE PLÁSTICO

MATERIAL: Plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.4	4.4
Altura Total	12.0	12.0
Cinta (mm)	-	-
Rosca	-	-
Código	COESR.M.5512-09	COESR.U.5512-10
Indexação	S/HEX	C/HEX

ANÁLOGO DO PILAR ESTETICONE S/ HEXÁGONO

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.0
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	AESHN
Indexação	S/HEX

Componentes Protéticos
HI ESTREITO

implus

LINHA HI
ESTREITO

TAPA IMPLANTE

REF TINI

CICATRIZADOR DIVERGENTE

REF CDNI.382-01
CDNI.383-02
CDNI.384-03
CDNI.385-04
CDNI.386-05

CICATRIZADOR C/ EMERGÊNCIA

REF CENI.382-01
CENI.383-02
CENI.384-03
CENI.385-04
CENI.386-05

CICATRIZADOR PARALELO

REF CPNI.342-01
CPNI.343-02
CPNI.344-03
CPNI.345-04
CPNI.346-05

UCLA TITÂNIO

REF PUNI.U.3816-01
PUNI.M.3816-02

UCLA CR-CO

REF PUNI.U.3813-03
PUNI.M.3813-04

PILAR DIVERGENTE

REF PDNI.382-01
PDNI.383-02
PDNI.384-03
PDNI.385-04
PDNI.386-05

PILAR PARALELO

REF PLNI.3812-01

PILAR ANGULADO

REF PANI.382-01
PANI.384-02

TRANSFERÊNTE MOLDEIRA ABERTA

REF TRINMAI

TRANSFERÊNTE MOLDEIRA FECHADA

REF TRINMFI

ANÁLOGO DO IMPLANTE

REF AINI

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPNI-03

PILAR MICROUNIT

REF PMNI.M.481-01
PMNI.M.482-02
PMNI.M.483-03
PMNI.M.484-04
PMNI.M.485-05
PMNI.M.486-06

PILAR MICROUNIT ANGULADO

REF PMANI.U.482-01
PMANI.U.483-02

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

REF TRMRMA

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

REF TRMRMF

TAMPA DE PROTEÇÃO

REF TPMI.484-01

COPING TITÂNIO

REF COMIM.5312-01

COPING CR-CO

REF COMIM.5313-03

COPING PLÁSTICO

REF COMIM.5312-05

ANÁLOGO DO PILAR MICROUNIT

REF APMR

PARAFUSO PROTÉTICO

REF PPCMI

COMPONENTES PROTÉTICOS ESTREITO

TAPA IMPLANTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	3.8
Altura Total	1.65
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.6
Código	TINI
Indexação	-

CICATRIZADOR C/ EMERGÊNCIA

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CENI.Ref (CENI.382-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Altura Total	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Cinta (mm)	-	-	-	-	-
Rosca	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6
Código	382-01	383-02	384-03	385-04	386-05
Indexação	-	-	-	-	-

UCLA DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	3.80	3.80
Altura Total	14.0	14.0
Cinta (mm)	1.1	1.1
Rosca	-	-
Código	PUNI.U.3816-01	PUNI.M.3816-02
Indexação	C/HEX	S/HEX

CICATRIZADOR DIVERGENTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CDNI.Ref (CDNI.382-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Altura Total	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1
Cinta (mm)	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1
Rosca	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6
Código	382-01	383-02	384-03	385-04	386-05
Indexação	-	-	-	-	-

CICATRIZADOR PARALELO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Manual 10Ncm
REF: CPNI.Ref (CPNI.342-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Altura Total	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1
Cinta (mm)	-	-	-	-	-
Rosca	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6
Código	342-01	343-02	344-03	345-04	346-05
Indexação	-	-	-	-	-

COMPONENTES PROTÉTICOS ESTREITO

UCLA Cr-Co

MATERIAL: Cinta metálica de Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	3.8	3.8
Altura Total	11.1	11.1
Cinta (mm)	1.1	1.1
Rosca	-	-
Código	PUNI.U.3813-03	PUNI.U.3813-04
Indexação	C/HEX	S/HEX

PILAR PARALELO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	3.8
Altura Total	10.7
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	PLNI.3812-01
Indexação	C/HEX

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	19.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.6
Código	TRINMAI
Indexação	C/HEX

PILAR DIVERGENTE

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PDNI.Ref (PDNI.382-01)

Plataforma	◇	◇	◇	◇	◇
Ø (mm)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Altura Total	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
Cinta (mm)	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1
Rosca	-	-	-	-	-
Código	382-01	383-02	384-03	385-04	386-05
Indexação	-	-	-	-	-

PILAR ANGULADO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	3.8	3.8
Altura Total	11.5	11.5
Cinta (mm)	2.0	4.0
Rosca	-	-
Código	PANI.382.01	PANI.384.02
Indexação	-	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	3.7
Altura Total	13.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.6
Código	TRINMFI
Indexação	C/HEX

ANÁLOGO DO IMPLANTE

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	3.4
Altura Total	10.7
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.6
Código	AINI
Indexação	-

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: 32Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.1
Altura Total	7.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.6
Código	PPNI-03
Indexação	-

LINHA MICROUNIT ESTREITO

PILAR MICROUNIT

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PMNI.M.Ref (PMNI.M.481-01)

Plataforma	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8
Altura Total	3.3	4.3	5.3
Cinta (mm)	1.1	2.1	3.1
Rosca	M1.6	M1.6	M1.6
Código	481-01	482-02	483-03
Indexação	S/HEX	S/HEX	S/HEX

Plataforma	◇	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8	4.8
Altura Total	6.3	7.3	8.3
Cinta (mm)	4.1	5.1	6.1
Rosca	M1.6	M1.6	M1.6
Código	484-04	485-05	486-06
Indexação	S/HEX	S/HEX	S/HEX

PILAR MICROUNIT ANGULADO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 32Ncm
REF: PMANI.U.Ref (PMANI.U.482-01)

Plataforma	◇	◇
Ø (mm)	4.8	4.8
Altura Total	3.8	4.8
Cinta (mm)	2.0	3.0
Rosca	M1.6	M1.6
Código	482-01	483-02
Angulação	17	17
Indexação	C/HEX	C/HEX

TRANSFERENTE MOLDEIRA ABERTA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	15.0
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRMRMA
Indexação	-

TRANSFERENTE MOLDEIRA FECHADA

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	8.2
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TRMRMF
Indexação	-

TAMPA DE PROTEÇÃO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	4.7
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	TPMI.484-01
Indexação	-

COPING DE TITÂNIO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	12.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5312-01
Indexação	S/HEX

COPING DE Cr-Co

MATERIAL: Cinta metálica Cr-Co, corpo plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	13.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5313-03
Indexação	S/HEX

ANÁLOGO DO PILAR MICROUNIT

MATERIAL: Aço Inox
TORQUE: Não Aplicável

Plataforma	◇
Ø (mm)	4.8
Altura Total	14.2
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	APMR
Indexação	-

COPING DE PLÁSTICO

MATERIAL: Plástico
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	5.3
Altura Total	12.0
Cinta (mm)	-
Rosca	-
Código	COMI.M.5312-05
Indexação	S/HEX

PARAFUSO PROTÉTICO

MATERIAL: Titânio
TORQUE: 15Ncm

Plataforma	◇
Ø (mm)	2.3
Altura Total	4.5
Cinta (mm)	-
Rosca	M1.4
Código	PPCMI
Indexação	-

Kits e Instrumentais implus

INSTRUMENTAIS

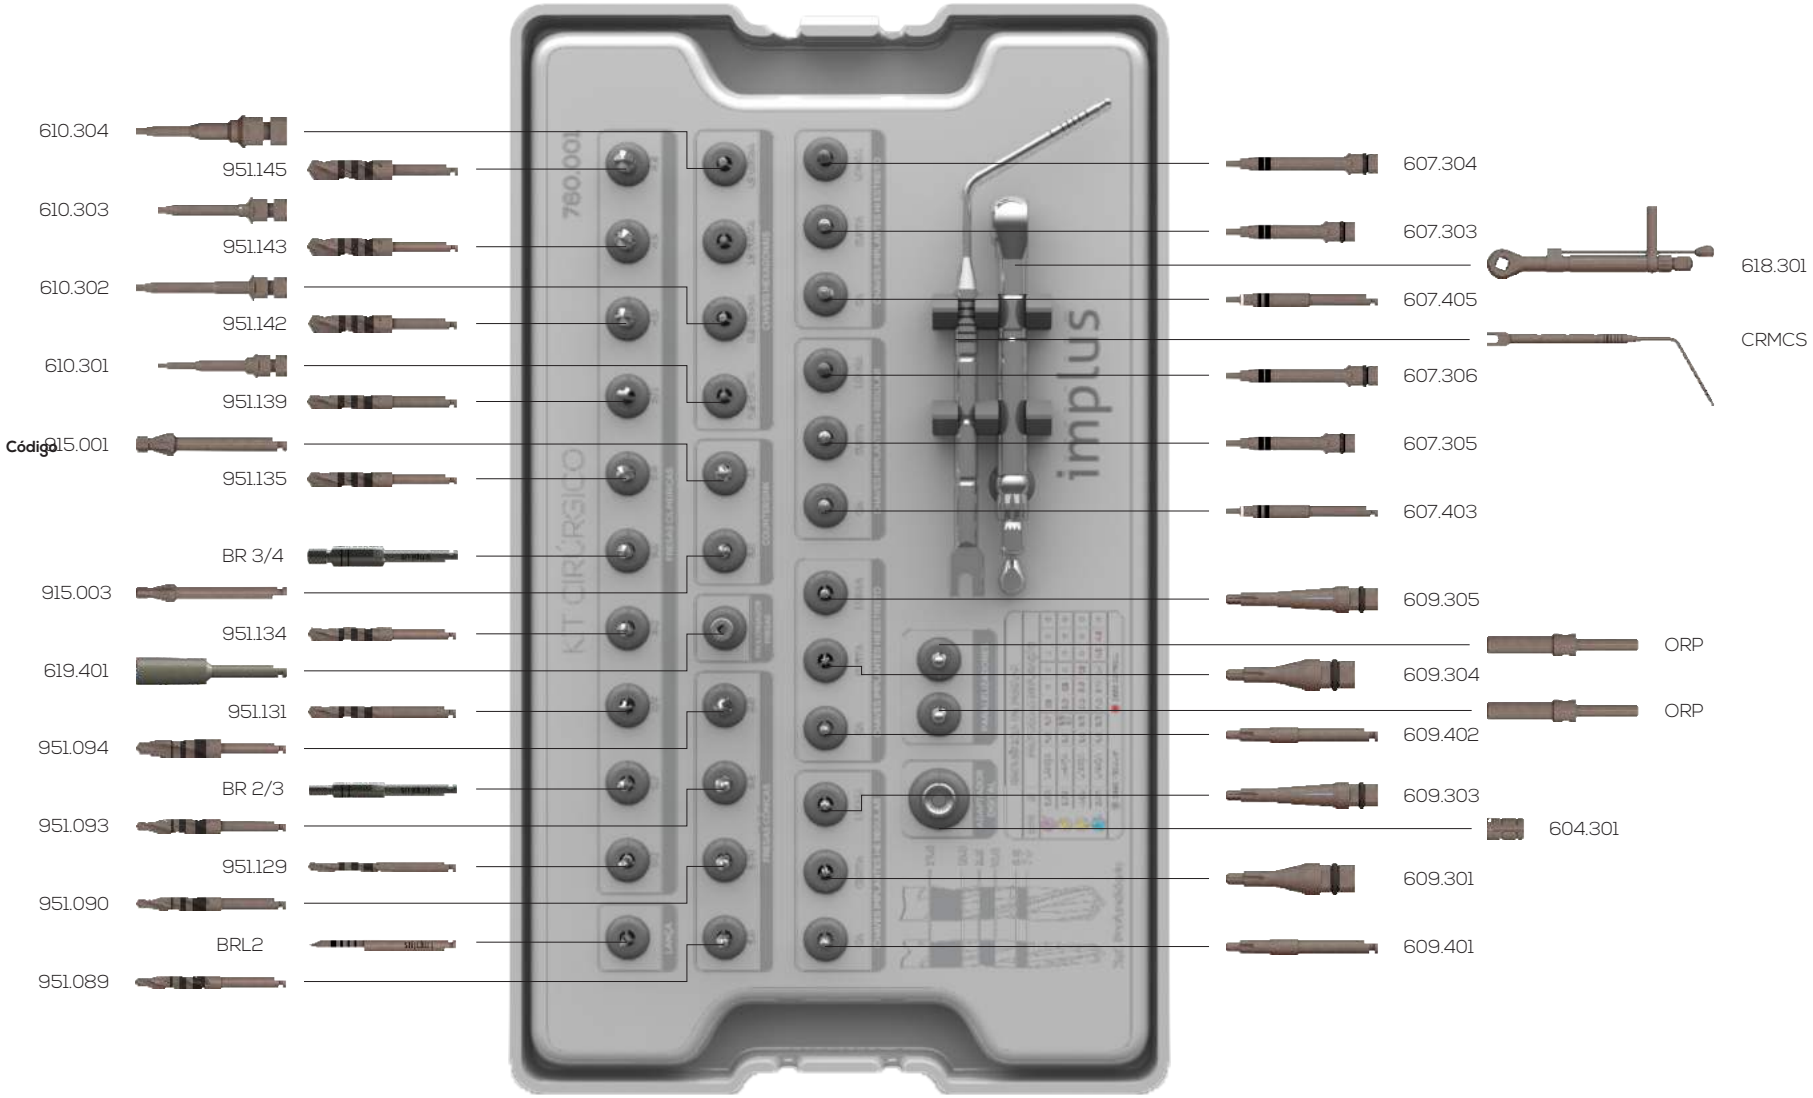

INSTRUMENTAIS

FRESA LANÇA

INDICAÇÃO: Indicada para realizar o ponto inicial para confecção dos alvéolos artificiais que receberão os implantes.
MATERIAL: Aço Inox

	Descrição
914.004	Fresa lança Ø 2.00mm

FRESA HELICOIDAL

INDICAÇÃO: Fresas helicoidais de irrigação externa, com marcações a laser, utilizadas para aumento progressivo do diâmetro dos alvéolos.
MATERIAL: Aço Inox

Código	Descrição
951.129	Fresa helicoidal Ø 2.00mm
951.131	Fresa helicoidal Ø 2.70mm
951.134	Fresa helicoidal Ø 3.00mm
951.135	Fresa helicoidal Ø 3.20mm
951.139	Fresa helicoidal Ø 3.50mm
951.142	Fresa helicoidal Ø 4.00mm
951.143	Fresa helicoidal Ø 4.20mm
951.145	Fresa helicoidal Ø 4.50mm

FRESA CÔNICA

INDICAÇÃO: Fresas helicoidais cônicas de irrigação externa, marcações e laser, utilizadas para aumento progressivo do diâmetro dos alvéolos
MATERIAL: Aço Inox

Código	Descrição
951.089	Fresa cônica Ø 3.50mm
951.090	Fresa cônica Ø 3.75mm
951.092	Fresa cônica Ø 4.30mm
951.093	Fresa cônica Ø 5.00mm

FRESA COUNTERSINK

INDICAÇÃO: Indicada para fazer a base de assentamento da plataformas dos implantes He e Hi PlusCut de plataforma Estreita e Regular.
MATERIAL: Aço Inox

Código	Descrição
915.001	Fresa countersink Ø 4.10mm
915.003	Fresa countersink Ø 3.50mm

CHAVE DE TORQUE

INDICAÇÃO: Indicado para instalação e fixação de tapa implantes HE.
MATERIAL: Aço inox.

Código	Descrição
610.301	Chave hexagonal curta de 0.90mm
610.302	Chave hexagonal longa de 0.90mm

CHAVE DE TORQUE

INDICAÇÃO: Indicado para instalação e fixação de parafusos e componentes protéticos em geral com encaixe hexagonal, utilizando torquímetro.
MATERIAL: Aço inox.

Código	Descrição
610.303	Chave hexagonal curta de 1.20mm
610.304	Chave hexagonal longa de 1.20mm

CHAVE BIDIGITAL

INDICAÇÃO: Indicado para instalação e fixação de tapa implantes HE.
MATERIAL: Aço Inox.

Código	Descrição
607.202	Chave digital 0.90mm - Microcurta
607.204	Chave digital 0.90mm - Curta
607.205	Chave digital 0.90mm - Longa

CHAVE BIDIGITAL

INDICAÇÃO: Indicado para instalação e fixação de parafusos e componentes protéticos em geral com encaixe hexagonal.
MATERIAL: Aço Inox.

Código	Descrição
607.203	Chave digital 1.20mm - Microcurta
607.206	Chave digital 1.20mm - Curta
607.207	Chave digital 1.20mm - Longa

INSTRUMENTAIS

CHAVE BIDIGITAL 2.0

INDICAÇÃO: Indicadas para instalação e fixação de pilares Chave 2.0 mm - Pilar Microunit, Pilar Esteticone, Pilar O'ring (Linha Pluscut HE e HI) entre outros.
MATERIAL: Aço Inox

Código	Descrição
607.208	Chave digital de 2.0mm

ADAPTADOR BIDIGITAL

INDICAÇÃO: Indicado para uso em conjunto com as chaves para catraca para utilização como chave bidigital.
MATERIAL: Aço Inox

Código	Descrição
604.301	

CHAVE DO IMPLANTE HE CA

INDICAÇÃO: Indicado para instalação do implante Pluscut e Maxplus HE.
MATERIAL: Aço inox.

Código	Descrição
609.401	Chave com adaptação em contra-ângulo torx REGULAR
601.402	Chave com adaptação em contra-ângulo torx ESTREITO

CHAVE DO IMPLANTE HE

INDICAÇÃO: Indicado para instalação do implante Pluscut e Maxplus HE.
MATERIAL: Aço Inox

Código	Descrição
609.301	Chave torx curta REGULAR
609.303	Chave torx longa REGULAR
609.304	Chave torx curta ESTREITO
609.305	Chave torx longa ESTREITO

CHAVE DO IMPLANTE HI

INDICAÇÃO: Indicado para instalação do implante Pluscut e Maxplus HI.
MATERIAL: Aço Inox

Código	Descrição
607.403	Chave com adaptação em contra-ângulo HI REGULAR
607.405	Chave com adaptação em contra-ângulo HI REGULAR

TORQUÍMETRO

INDICAÇÃO: Utilizado para controle do torque de instalação dos implantes e componentes. Indicado para utilização com instrumentais com encaixe quadrado. Faixa de medição entre 10 e 60 Ncm.
MATERIAL: Aço Inox

Código	Descrição
618.301	Torquímetro

ORIENTADOR DE PARALELISMO

INDICAÇÃO: Utilizado para auxiliar no correto paralelismo na loja cirúrgica em relação aos dentes/implantes adjacentes durante a osteotomia.
MATERIAL: Titânio.

Código	Descrição
ORP	Orientador de paralelismo

CHAVE RETA PARA MONTADOR

INDICAÇÃO: Indicada como suporte para contra-torque na remoção do montador e auxílio no planejamento protético/cirúrgico.
MATERIAL: Aço Inox.

Código	Descrição
CRMCS	Chave reta para mount

PROLONGADOR DE FRESA

INDICAÇÃO: Utilizado em situações onde existe a necessidade de um aumento do comprimentos das fresas
MATERIAL: Aço Inox

Código	Descrição
619.401	Prolongador de fresa

CHAVE PARA CONTRA-ÂNGULO

INDICAÇÃO: Indicado para uso em conjunto com as chaves de torque ou montador.
MATERIAL: Aço Inox.

Código	Descrição
CCE	Chave para contra-ângulo.

MACHO DE ROSCA

INDICAÇÃO: Formação de roscas no interior da loja cirúrgica de ossos tipo I e II.
MATERIAL: Titânio.

Código	Descrição
793.003	Macho de rosca.
795.002	Macho de rosca.

KIT CIRÚRGICO IMPLUS

O Kit cirúrgico Implus foi projetado para atender todas as necessidades do cirurgião dentista.

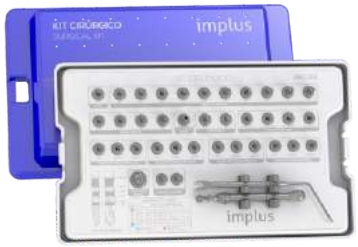

Ref	Descrição
760.001	Kit cirúrgico Implus

Ref	Descrição	Quantidade
BRL2	Fresa Lança 2.0mm	1
951.129	Fresa Helicoidal 2.0mm	1
BR 2/3	Fresa Pilot 2/3	1
951.131	Fresa Helicoidal 2.7mm	1
951.134	Fresa Helicoidal 3.0mm	1
BR 3/4	Fresa Pilot 3/4	1
951.135	Fresa Helicoidal 3.2mm	1
951.139	Fresa Helicoidal 3.5mm	1
951.142	Fresa Helicoidal 4.0	1
951.143	Fresa Helicoidal 4.2	1
951.145	Fresa Helicoidal 4.5	1
951.089	Fresa Cônica 3.5mm	1

Ref	Descrição	Quantidade
951.090	Fresa Cônica 3.75mm	1
951.092	Fresa Cônica 4.30mm	1
951.093	Fresa Cônica 5.0	1
619.401	Prolongados de Fresas	1
915.003	Fresa Countersink 3.5	1
915.001	Fresa Countersink 4.1	1
610.301	Chave Hexagonal de 0.9mm (Curta)	1
610.302	Chave Hexagonal de 0.9mm (Longa)	1
610.303	Chave Hexagonal de 1.2 mm (Curta)	1
610.304	Chave Hexagonal de 1.2 mm (Longa)	1
609.401	Chave do Implante HE (Contra-Ângulo) - Curta	1
609.301	Chave do Implante HE (Catraca) - Curta	1
609.302	Chave do Implante HE (Catraca) - Longa	1
609.402	Chave do Implante HE Estreito (Contra-Ângulo) - Curta	1
609.304	Chave do Implante HE Estreito (Catraca) - Curta	1
609.305	Chave do Implante HE Estreito (Catraca) - Longa	1
607.403	Chave do Implante HI (Contra-Ângulo) - Curta	1
607.305	Chave do Implante HI (Catraca) - Curta	1
607.306	Chave do Implante HI (Catraca) - Longa	1
607.405	Chave do Implante HI Estreito (Contra-Ângulo) - Curta	1
607.303	Chave do Implante HI Estreito (Catraca) - Curta	1
607.304	Chave do Implante HI Estreito (Catraca) - Longa	1
604.301	Adaptador Digital	1
ORP	Pino de Paralelismo	2
CRMCS	Sonda de Profundidade	1
618.301	Torquimetro	1

KIT DE FRESAS

Ref	Descrição
760.005	Kit de Fresas Cilíndricas

Ref	Descrição	Qtde.
BRL2	Fresa Lança 2.0 mm	1
951.129	Fresa Helicoidal 2.0 mm	1
BR 2/3	Fresa Pilot 2/3	1
951.131	Fresa Helicoidal 2.7 mm	1
951.134	Fresa Helicoidal 3.0 mm	1
BR 3/4	Fresa Pilot 3/4	1
951.135	Fresa Helicoidal 3.2 mm	1
951.139	Fresa Helicoidal 3.5 mm	1
951.142	Fresa Helicoidal 4.0 mm	1
951.143	Fresa Helicoidal 4.2 mm	1
951.145	Fresa Helicoidal 4.5 mm	1

KIT DE FRESAS CÔNICAS

Ref	Descrição
760.006	Kit de Fresas Cônicas

Ref	Descrição	Qtde.
BRL2	Fresa Lança 2.0 mm	1
951.129	Fresa Helicoidal 2.0 mm	1
951.089	Fresa Cônica 3.5 mm	1
951.090	Fresa Cônica 3.75 mm	1
951.092	Fresa Cônica 4.30 mm	1
951.093	Fresa Cônica 5.0 mm	1
619.401	Prolongados de Fresas	1

KIT DE CHAVES TORQUÍMETRO

Ref	Descrição
760.007	Kit de Chaves

Ref	Descrição	Qtde.
609.401	Chave do Implante HE (CA) - Curta	1
609.301	Chave do Implante HE (Catraca) - Curta	1
609.302	Chave do Implante HE (Catraca) - Longo	1
609.402	Chave do Implante HE Estreito (CA) - Curta	1
609.304	Chave do Implante HE Estreito (Catraca) - Curta	1
609.305	Chave do Implante HE Estreito (Catraca) - Longo	1
607.403	Chave do Implante HI (CA) - Curta	1
607.305	Chave do Implante HI (Catraca) - Curta	1
607.306	Chave do Implante HI (Catraca) - Longo	1
607.405	Chave do Implante HI Estreito (CA) - Curta	1
607.303	Chave do Implante HI Estreito (Catraca) - Curta	1
607.304	Chave do Implante HI Estreito (Catraca) - Longo	1

1º PASSO | HIGIENIZAÇÃO PRÉVIA OU DESINCRUSTAÇÃO

1.1 - Realizar a limpeza dos instrumentais imediatamente após a utilização cirúrgica para remoção da matéria orgânica dos instrumentais, sem contato manual direto.
1.2 - Para o torquimetro 618.301, deverá ser realizado o processo de desmontagem completa para retirada do material orgânico interno.

ORIENTAÇÕES:
- O responsável pela tarefa deverá estar paramentado, com os equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, óculo, avental, gorro, etc.).
- Utilizar solução enzimática, em concentração e tempo de exposição determinados pelo fabricante destas soluções químicas.
- Realizar enxágue único, diretamente em jato de água (destilada, deionizada ou desmineralizada), sem manusear os instrumentais cirúrgicos.

2º PASSO | DESCONTAMINAÇÃO

2.1 - É a remoção dos micro-organismos na forma vegetativa.
2.2 - A limpeza destes artigos oferecem riscos ocupacionais.

ORIENTAÇÕES:
- Utilize sempre para este procedimento água destilada, deionizada ou desmineralizada, para facilitar a limpeza dos instrumentais, aquecer a água no mínimo a 45°C.
- Não utilize soluções salinas, hipoclorito de sódio, desinfetantes, água oxigenada, soro fisiológico ou álcool para limpeza ou enxague nos instrumentais cirúrgicos

3º PASSO | LAVAGEM

3.1 - É a remoção manual ou automatizada dos resíduos dos instrumentais cirúrgicos através de escovação manual ou vibrações produzidas por ultrassom.

ORIENTAÇÕES:

- Utilize sempre para este procedimento água destilada, deionizada ou desmineralizada, para facilitar a limpeza dos instrumentais, aquecer a água no mínimo a 45°C.
- Utilizar solução enzimática, em concentração e tempo de exposição determinados pelo fabricante destas soluções químicas.
- Utilizar sempre escovas com cerdas macias naturais ou de nylon para a limpeza de cremalheiras, serrilhas e encaixes.
- Nunca utilizar palhas ou esponjas de aço e produtos abrasivos, para que os instrumentos não sejam danificados.
- Não acumular os instrumentais em grandes quantidades, uns sobre os outros, para evitar a deformação de peças menores e delicadas.
- A limpeza por ultrassom, se utilizada, deve ter a solução para lavagem aquecida a pelo menos 45ºC, e os instrumentais devem ser colocados na posição aberta. De três a cinco minutos de imersão, em uma frequência de 35 kHz, é tempo suficiente para a limpeza dos instrumentos.
- Inspecionar e verificar a necessidade de escovação das partes serrilhadas e das articulações.

4º PASSO | ENXÁGUE

4.1 - É a remoção de resíduos químicos, detergentes e espumas presentes nos instrumentais cirúrgicos.

ORIENTAÇÕES:

- Sempre utilizar água destilada, deionizada ou desmineralizada. Se a água estiver aquecida, sua temperatura deverá estar no mínimo a 45ºC.
- Não utilize soluções salinas, hipoclorito de sódio, desinfetantes, água oxigenada, soro fisiológico ou álcool para limpeza ou enxague dos instrumentais cirúrgicos.

5º PASSO | SECAGEM

5.1 - É a retirada de água residual e umidade, após o procedimento de enxágue.

ORIENTAÇÕES:
- Nunca deixar o instrumento secar de "forma natural" para evitar manchas.
- Utilizar sempre tecido macio e absorvente (por exemplo, compressas) ou ar comprimido isento de umidade.

6º PASSO | ESTERILIZAÇÃO

6.1 - É o procedimento que visa a eliminação total dos micro-organismos (vírus, bactérias, micróbios e fungos), seja na forma vegetativa ou esporulada.
Deve se realizar todas as etapas que antecedem o processo de ESTERILIZAÇÃO para segurança na desinfecção dos instrumentais cirúrgicos IMPLUS.

ORIENTAÇÕES:
- Utilizar indicadores mecânicos e químicos para cada ciclo de esterilização.
- O estojo autoclavável IMPLUS deverá ser acomodado em superfície plana e afastado das paredes do aparelho.
- Nunca sobreponha objetos e outros estojos.
- O estojo autoclavável IMPLUS pode ser esterilizado a 121°C a 1 ATM de pressão durante 30 minutos ou 135°C a 2 ATM de pressão durante 20 minutos.
- Manter os instrumentais no esterilizador até seu resfriamento e secagem para evitar contaminação e oxidação dos instrumentais.

DADOS EMPRESARIAIS

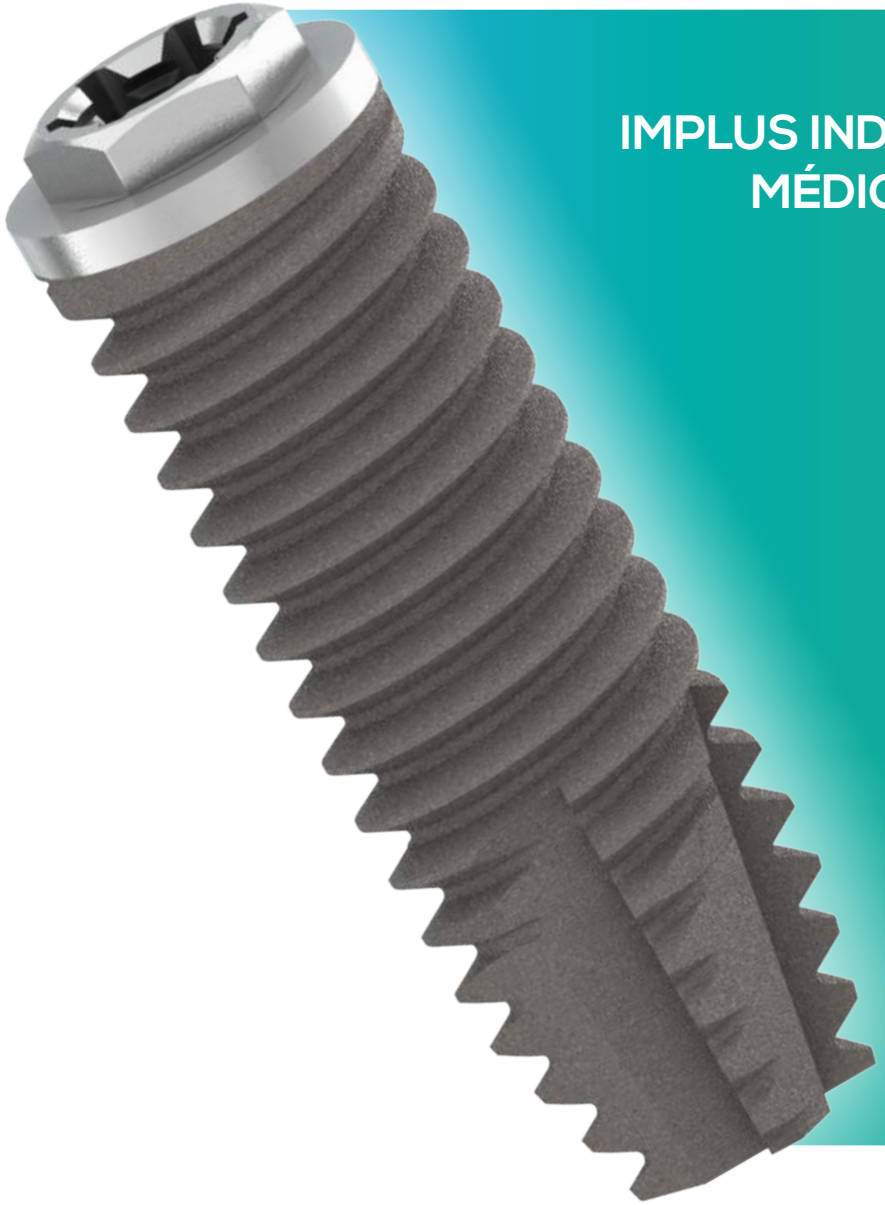

IMPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP

Endereço da Implus:
Rua Eng. Mariano Jatahy Ferraz ;60,
CEP:2461030, São Paulo - SP

Tel.:
(11) 3670-0000

Televendas
0800 777 7655

e-mail de vendas:
cml.implus@baumer.com.br
sac.implus@baumer.com.br

Rev. 00 - Julho/16